


ET19J207C

ET-C207S

TERUMO
テルモ電子体温計C207

ET-C207S J20.001.03

予測試 平均約30秒 → 実測検温
平均約30秒で体温を予測し、約4分30秒後、実測検温に移行します。

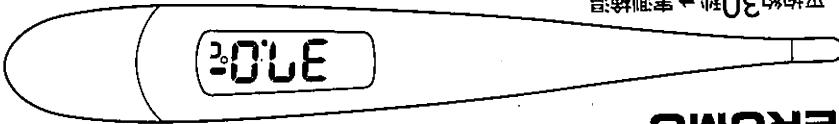

病院用 テルモ電子体温計C207

TERUMO
テルモ電子体温計C207
【 腔下 】

TERUMO



2629112687864



班検査合格

お買い上げ 2025年5月8日
お買い上げ店名

販売名 テルモ電子体温計C207
お名前 TEL
ご住所


MADE IN CHINA



管理販売番号 一般名称: 電子体温計
販売名: テルモ電子体温計C207
医療機器登録番号: 302A82X00003
製造販売業者: テルモ株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目44番1号
お問い合わせは大切に保管してください。
内容物・本体・収納ケース・添付文書・EMC技術資料
コード番号: ET-C207S

病院用 テルモ電子体温計C207

ET-C207S



LOT 23-C10A

002378
(01)04987892116282(10)23-C10A

TERUMOはテルモ株式会社の登録商標です。
テルモはテルモ株式会社の登録商標です。

(4) 本製品は日本国内においてのみ有効です。
(5) 仕組は改修のため予告なく変更する場合があります。
(6) 保証書は発行いたしません。大切に保管してください。

(1) 正しい検温 (使用後はケースに入れないこと) で検温に努めてください。
(2) 検温の際は、検温部位の皮膚を清潔に保ち、検温部位の乾燥に注意してください。
(3) 検温の際は、検温部位の皮膚を清潔に保ち、検温部位の乾燥に注意してください。
(4) 検温の際は、検温部位の皮膚を清潔に保ち、検温部位の乾燥に注意してください。

【保証書】
(1) 保証期間は、お買い上げ後1年間です。
(2) 使用中に、故障が発生した場合は取扱店又は
お買い上げ店へお問い合わせください。
(3) ただし、下記の場合は保証の対象になりません。
(4) 使用中で故障の原因が不明な場合 (お買い上げ店へお問い合わせください)。
(5) 検温の際に、検温部位の皮膚を清潔に保ち、検温部位の乾燥に注意してください。
(6) 検温の際に、検温部位の皮膚を清潔に保ち、検温部位の乾燥に注意してください。